

四平市中心人民医院 骨科手术床+碳纤维牵引架

一、采购内容:

序号	采购方式	采购项目	申购科室	数量	预算金额
1	院内采购	骨科手术床+碳纤维牵引架	手术一室	1台	40万元

二、比选须知:

参选单位在规定时间内递交院内比选文件至指定地点。递交院内比选文件的时间、地点及具体要求详见后文说明;请仔细阅读相关内容,如有贻误,后果自负。参选单位提供的资料均应是真实有效的,若有虚假,由其承担一切后果。依据医院采购流程,以现场评审专家与投标单位进行竞谈后的二次报价为准。

递交的文件内容应全面符合本公告“第四项文件要求”中全部内容,并胶装订成册(一正本、五副本),比选文件内容不全将取消参加资格!

三、项目参数:

电动骨科手术床参数

- 1、用途:可配合各种品牌 C 型臂开展骨科手术,包括脊柱、关节、四肢等手术
- 2、基本配置(包括但不限于):主机、碳纤维床面板、线控器、床垫、肩侧垫、绑带、头托、手托、手固定带、输液支架、麻醉屏架、悬空式碳纤维骨科牵引架
- 3、基本参数:
 - 3.1 技术参数:
 - 3.1.1 床面板尺寸: $\geq 2300\text{mm} \times 500\text{mm}$
 - 3.1.2 床面距地面高度: $\geq 650\text{mm}$, 床面升降高度(电动): $\geq 300\text{mm}$
 - 3.1.3 床面纵向移动行程(电动): $\geq 200\text{mm}$
 - 3.1.4 前/后倾斜角度(电动): $\geq -20^\circ \sim +20^\circ$
 - 3.1.5 左/右倾斜角度(电动): $\geq -20^\circ \sim +20^\circ$
 - 3.1.6 背板上/下角度(电动): $\geq -20^\circ \sim +80^\circ$
 - 3.1.7 脚板上/下角度: $\geq -90^\circ \sim +60^\circ$
 - 3.1.8 脚板水平角度: $\geq 0^\circ \sim 90^\circ$
 - 3.1.9 最大承重: $\geq 200\text{kg}$
 - 3.2 主机:
 - 3.2.1 控制方式:采用微电机控制,无需定期添加液压油
 - 3.2.2 导轨:采用高精度直线导轨
 - 3.2.3 床体:采用铝合金和 304 不锈钢材质



3.2.4 配有蓄电池及充电装置

3.2.5 配有底座刹车装置

3.3 碳纤维床面板：采用碳素纤维制作，全透光结构，无金属长度 $\geq 1150\text{mm}$

3.3 线控器（包括但不限于）：头高脚低、头低脚高、整体上、整体下、左倾、右倾、背下、背上、复位

3.4 床垫采用记忆海绵材质

3.5 肩侧垫 1 对、绑带 1 套、头托 1 个、手托 1 对、手固定带 2 套、输液支架 1 套、麻醉屏架 1 套

3.6 悬空式碳纤维骨科牵引架：

3.6.1 牵引架长度： $\geq 1600\text{mm}$

3.6.2 牵引架升降高度： $\geq 700\text{mm} \sim 1000\text{mm}$

3.6.3 牵引行程： $\geq 400\text{mm}$

3.6.4 两伸展杆夹角： $0^\circ \sim 180^\circ$

3.6.5 脚牵引器升降行程： $\geq 300\text{mm}$

3.6.6 脚牵引器伸缩行程： $\geq 100\text{mm}$

3.6.7 盆骨座：碳素纤维材质

3.6.8 最大承重： $\geq 100\text{kg}$

※提示：比选会议现场须有专业技术人员参会，必要时取消参标资格。

四、文件要求：

1、清单要求：

①设备详细配置清单及报价

②提供多家同类项目合同

③近 1 年公司财务状况证明（以会计事务所、信用评估机构或银行出具为准）

2、资格要求

①具有独立法人资格，在工商局有注册登记且营业范围涵盖本次比选内容，在有效期内。有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章。

②参加本次比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供证明文件或承诺书）

③项目人员委托授权书和身份证复印件。

3、投标廉洁承诺书（※ 采购公告中下载）

所有投标比选单位必须签署《投标廉洁承诺书》一式三份，投标单位负责人签字并加盖公章，会议现场递交。

4、参选单位根据比选文件要求标明单位名称、比选项目名称、联系人、联系电话并加盖公章，提供的资格证明材料、项目详细清单、报价等文件全部加盖公章；参选文件均应编写目录和页码。无需购买标书。

※以上所有材料胶装成册（1 正本 5 副本），整体封存。

※《项目评分标准》详见附件 1

5、请符合院内比选文件要求的参选单位，于 2021 年 6 月 3 日 11:00 前送到招标采购办公室（可邮寄），逾期传递或不符合规定的投标文件恕不接受。

收件地址：吉林省四平市铁西区中心人民医院体检中心

联系人：蒋志远


联系电话：13624440170

五、各生产或经营企业所提供的证件必须真实有效，如发现造假者，立即终止交易活动，并上报上级主管部门处理。

联系方式：

四平市中心人民医院 招采办 蒋志远 04343608866（文件咨询）

四平市中心人民医院 医工部 邱部长 13843413051（技术咨询）

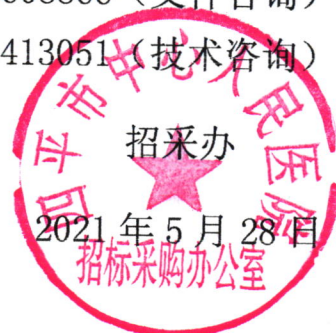

四平市中心人民医院
招标采购办公室

附件 1:

项目评分标准

序号	评分因素及权重	分值	评分标准	说明
1	价格因素	30分	满足项目要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30	
2	业绩	10分	近三年同类设计业绩，根据合同数量，每一个得2分，最多得10分	提供合同复印件加盖公章
3	技术指标和方案	40分	完全符合比选文件要求，没有负偏离得20分。与比选文件要求有非实质性的负偏离的扣分，每条扣2分，扣完为止。 技术指标和配置高于比选要求并体现处产品的质量和性能更优的可加分，最多加20分。	
4	售后方案	15分	提供免费保修期最短的不得分，每增加一年得3分，最多得15分。	
5	财务状况	3分	提供近1年的财务报表，报表完整得、财务状况良好的得3分，一般的得2分，差得1分，不完整及不提供的得0分。	以会计师事务所、信用评级机构或银行出具为准
6	投标文件的规范性	2分	投标文件规范，没有细微偏差情形得2分，有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。	
7	设备耗材情况	-15分	设备不需要配套使用耗材的不扣分，需要配套使用耗材的按下述标准扣分： 需独家提供专机专用耗材的扣5分；非专机专用耗材的不扣分； 耗材不属于省物价平台可收费项目的扣5分；属于可收费项目的不扣分； 耗占比高于30%的扣5分；耗占比低于30%的不扣分。	该项为扣分项